


ტექნიკური დოკუმენტაცია

№	ტექნიკური არწერილობა (სადაც მითითებულია მწარმოებელი ქვეყანა, მწარმოებელი კომპანია, სასაქონლო ნიშანი, პატენტი და მოდელი იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“)	რაოდენობა
1	ხმლის გარდე კომპლექტში FIE -ს სტანდარტი, საკეტიტ და იზოლაციით, მარჯვენა	20
2	ხმლის მუზარადი FIE- ს სტანდარტი, 1600 ნიუტონიანი, მარჯვენა N1	3
3	ხმლის მუზარადის მასა, FIE-ს სტანდარტი	20
4	ხმლის ელექტრო ქურთუკი FIE-ს სტანდარტი, რეცხვადი, INOX, მარჯვენა N44,N42,N42	3
5	წარწერა ელექტრო ქურთუკზე	3
6	ხმლის ხელთათმანი FIE-ს სტანდარტი, N8	6

7	საფარიკაო ეტლი. ზომები მითითებულია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში (FOOTREST) ფეხის საყრდენი: • (With height adjustment) სიმაღლის რეგულატორით; • (Individual aluminum footrest) ინდ. ფეხის საყრდენი, ალუმინის. (MAIN) მთავარი ბორბლები (თვლები): • (Sport, crossed spokes) სპორტული, ჯვარედინი სპიცებით. (TYRES) საბურავები: • Schwalbe Right Run. (MAIN-WHEEL AXLES) მთავარი ბორბლების ღერძები: • (Ø 1/2 inch (12,7mm), quick release) Ø 1/2 ინჩიანი (12,7მმ), სწრაფი მოხსნის ფუნქციით. (HANDRIMS) ბორბლების სახელურები: • (Aluminum) ალუმინის. (SIDEGUARDS) გვერდითი პროტექტორები: • (Plastic) პლასტმასის. (FENCING HANDLE) საფარიკაო სახელური: • (Mounted on clamps) დამონტაჟებული დამჭერებზე. (SEAT) ეტლის სავარძელი: • (Type: on Velcro belts, adjustable) ტიპი: Velcro ქამარზე, რეგულირებადი. CUSHION / PILLOW ეტლის სავარძლის ბალიში: • (Standard foam cushion) სტანდარტული ქაფის ბალიში; • (Breathable cushion cover) ბალიშის სარჩული სუნთქვადი. (BACKREST UPHOLSTERY) საზურგის სარჩული: • (Breathable backrest upholstery) საზურგის სარჩული სუნთქვადი; • (Alcantara backrest wings) საზურგის ფრთები: Alcantara. (BACKREST) საზურგე: • (Type: Rigid) ტიპი: ხისტი. (FRAME PAINTING) ჩარჩოს საფარი(სადუბავი): • (Raw frame) დაუმუშავებელი ჩარჩო.	1
---	---	---

საფარიგებო პელოს ზომები

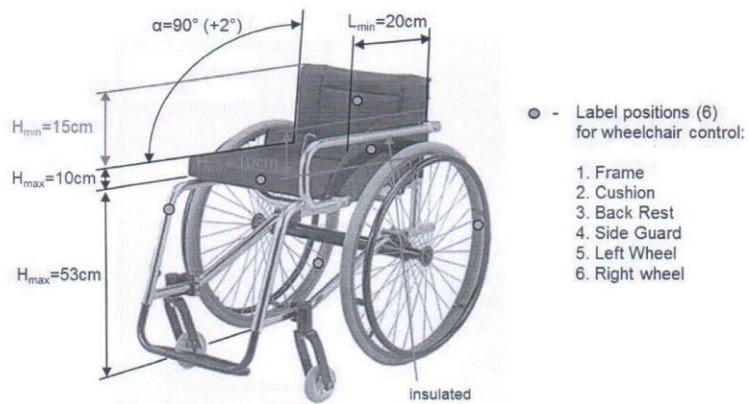

Fencing wheelchair for right-handed fencers

In Blue: Measurements taken with fencer seated on cushion

Figure 13.1. The Fencing Wheelchair

This diagram is for guidance purposes only. In case of any doubt the wording of the appropriate text takes precedence

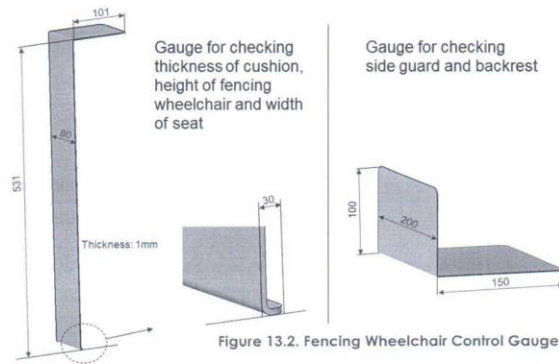


Figure 13.2. Fencing Wheelchair Control Gauges

RULES SPECIFIC TO FOIL
GLOVE (cf. m.25)